

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**Percutaneously implanted filter in blood vessel - is made from biologically decomposable material and has hooks to engage walls of blood vessel**

**Patent number:** DE4030998  
**Publication date:** 1991-04-18  
**Inventor:** STRECKER ERNST PETER PROF DR M (DE)  
**Applicant:** STRECKER ERNST PETER PROF DR M (DE)  
**Classification:**  
- **international:** A61F2/02; A61L27/00; A61L29/00; A61M25/00  
- **european:** A61F2/01  
**Application number:** DE19904030998 19901001  
**Priority number(s):** DE19904030998 19901001; DE19893933061 19891004

**Abstract of DE4030998**

The blood vessel filter is percutaneously implanted in the blood vessel by a catheter. The filter (10) is supported by a number of short rods (12) which are joined to each other at one of their ends (11) whilst the other ends are formed into hooks (15) which grip the wall of the blood vessel (16).

The filter (10) is made from biologically decomposable material and is operational for only as long as is necessary to achieve its therapeutic purpose. In the implanted condition the part of the filter furthest from the wall of the blood vessel decomposes more quickly than the parts close to the blood vessel wall.

USE - Blood vessel filter.

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

12 Patentschrift  
10 DE 40 30 998 C 2

61 Int. Cl.<sup>8</sup>:  
A 61 F 2/01  
A 61 M 25/00  
A 61 L 27/00  
A 61 L 29/00  
A 61 B 17/22

21 Aktenzeichen: P 40 30 998.3-35  
22 Anmeldetag: 1. 10. 90  
43 Offenlegungstag: 18. 4. 91  
45 Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 23. 11. 95

DE 40 30 998 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

30 Innere Priorität: 32 33 31  
04.10.89 DE 39 33 081.3

73 Patentinhaber:  
Strecker, Ernst Peter, Prof. Dr.med., 76228 Karlsruhe,  
DE

74 Vertreter:  
Geitz, H., Dr.-Ing., Pat.-Anw., 76133 Karlsruhe

72 Erfinder:  
gleich Patentinhaber

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 38 30 481 C2  
DE 38 01 426 C2  
DE 37 06 077 C1  
DE 28 21 570 C2  
DE-PS 1 79 096  
DE 29 17 037 B1  
DE 39 00 517 A1  
DE 38 11 231 A1  
DE 32 13 812 A1  
DE 29 17 446 A1  
DE 6 89 02 516 T2  
DE 39 00 515  
DE 38 83 078 T2  
GB 22 13 731 A  
US 47 93 348  
US 47 27 873  
US 35 40 431  
EP 02 04 931 A1  
EP 02 02 444 A2  
EP 3 50 043 A1  
EP 3 48 295 A1  
EP 2 93 605 A1  
EP 1 88 927 A2  
EP 1 65 713 A1

DÉ-Z: SCHLAG, P.: Voll implantierbare Katheter-  
systeme- erfüllen sie die Erwartungen? In:  
Münch.med.Wschr.130, Nr.7,1988, S.102-105;  
Interventionelle Radiologie.-Stuttgart: Georg  
Thieme Verlag, S.258-278;

54 Perkutan Gefäß-Filter

DE 40 30 998 C 2

Die Erfindung bezieht sich auf einen perkutan mittels eines Katheters in ein Gefäß einführbaren und in letzterem plazierbaren Filter aus wenigstens einem unter

Vorspannung radial zusammendrückbaren und im implantierten Zustand bis zur Anlage an einer Gefäßwand auffedernden Strang. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf einen perkutan implantierbaren Cava-Filter. In der Literatur sind bereits perkutan implantierbare Cava-Filter vorbeschrieben (Interventionelle Radiologie, Georg Thieme Verlag Stuttgart/New York, Seiten 258 bis 278). Dabei handelt es sich um beispielsweise in der Vena cava (untere Hohlvene) plazierbare Drahtgebilde aus Edelstahl, die durch einen Katheter hindurch

implantiert werden. Mittels derartiger Filter kann eine mechanische Teilblockade der Hohlvene erreicht und dadurch die Zufuhr im Blutstrom enthaltener Embolie zur Lunge wirksam unterbunden werden. Derartige Embolie können lebensgefährliche Lungenembolien oder ein chronisches Cor pulmonale auslösen, da die Lungenstrombahn vermindert wird. Weitere perkutan mittels eines Katheters in ein Gefäß implantierbare Filter dieser Art sind beispielsweise aus der DE 689 02 516 T2, der EP 01 65 713 A1 und der DE 38 83 078 T2 vorbekannt. Derartige Filter genügen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung je nach Ausgestaltung auf unterschiedliche Weise. Sie geben aber insofern Anlaß zu Beanstandungen, als es unbeschadet ihrer Ausführung aus Edelstahl oder speziellen Metall-Legierungen zu Langzeitkorrosionen kommen kann, die unter Umständen zu erheblichen Beeinträchtigungen eines mit einem derartigen Implantat versorgten Patienten führen können. Dies ist umso schwerwiegender, als derartige Implantate nach einmaliger Platzierung in einem Gefäß in aller Regel über die gesamte noch verbleibende Lebensdauer eines Patienten in dessen Körper belassen werden.

Es ist aber auch schon beobachtet worden, daß nach einer gewissen Zeit ganze Filter sich von der Venenwand gelöst haben und in die Lungenstrombahn verschleppt worden sind, von wo sie dann chirurgisch entfernt werden mußten. Auch kann es vorkommen, daß die Streben derartiger Filter die Venenwand penetrieren und benachbarte Organe verletzen, wie z. B. den Darm eines Patienten.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht daher in der Schaffung eines dahingehend verbesserten Gefäß-Filter, daß von diesem ausgehende Risiken im Vergleich zum Stande der Technik minimiert werden.

Gelöst ist diese Aufgabe dadurch, daß der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebene Gefäß-Filter erfindungsgemäß aus biologisch abbaubarem Material besteht und daß die — im implantierten Zustand — gefäßwandfernen Implantateile schneller abbaubar sind als die gefäßwandnahen Implantateile.

Bei der Erfindung handelt es sich somit um einen Gefäßfilter, der aufgrund seiner biologischen Abbaubarkeit nur für einen therapeutisch erwünschten Zeitschnitt nach der Implantation seine bestimmungsgemäße Funktion ausübt. Als geeignete Materialien haben sich insbesondere Poly-Lactide erwiesen. In Betracht kommen aber auch andere biologisch abbaubare Substanzen, wie Polymere.

Die Erfindung geht aus von der Überlegung, daß eine Belassung eines Gefäß-Filter im Körper des jeweiligen Patienten aus therapeutischen Gründen in aller Regel nicht erforderlich und häufig auch nicht erwünscht ist,

aber eine chirurgisch operative Entfernung angesichts der damit verbundenen Patientenbelastung nicht in Betracht kommt.

Aus resorbierbaren Materialien bestehende Implantate, die nach der Implantation im Körper eines Patienten verbleiben und dort nach einer vorbestimmten Zeitdauer biologisch abgebaut werden, sind schon bekannt. So beschreibt bereits die DE-PS 1 79 096 sogenannte Darmknöpfe und andere bei chirurgischen Operationen verwendete und im Körper eines Patienten verbleibende Verbindungsstücke aus biologisch abbaubarem Material. Aus der DE 38 11 231 A1 ist ein tubusförmiges chirurgisches Implantat bekannt, das aus resorbierbarem Material besteht und zur Unterstützung der Organ- und Gewebshheilung dient. Desgleichen beschreibt die EP 02 02 444 A2 eine tubusförmige Prothese aus ebenfalls resorbierbarem Material, nämlich einem im Körper absorbierbaren Polymer. Aus der DE-OS 38 01 426 schließlich ist ein filzartiges Implantat bekannt, das aus einem Gemisch verhältnismäßig kurzer Filamente oder Fasern aus resorbierbaren Materialien besteht und für vielfältige Zwecke einsetzbar sein soll, in denen die früher flächenhaften und textilartigen Gebilde oder kissenartige Implantatpolster nicht ausreichen.

Gegenstand der Erfindung ist hingegen ein perkutan implantierbarer Gefäß-Filter, der durch Verschieben durch einen Katheter in einem Gefäß plaziert wird und so beschaffen ist, daß über eine vorbestimmte Zeitdauer die bestimmungsgemäße Wirksamkeit gewährleistet ist, danach aber ein von den gefäßwandfernen Teilen aus allmählich fortschreitender biologischer Abbau bis zur vollständigen Auflösung des Implantats stattfindet. Durch den Implantatabbau von seinen gefäßwandfernen Bereichen aus ist ein unerwünschtes Abschwimmen noch während der Abbauphase der in einem Gefäß verbliebenen Implantateile wirksam unterbunden.

Der Verbleib von Gefäß-Filtern im Körper eines Patienten ist nach dem Abheilen einer Emboliequelle therapeutisch darum nicht angezeigt, weil sich die Vena cava aufgrund der Thrombogenität des Filters oder durch abgefangene Embolie vollständig verschließen und dadurch eine untere Einflußstauung des Körpers entstehen kann. Durch die gezielte Auflösung des aus resorbierbarem Material gefertigten Cava-Filter nach der Erfindung werden solche Komplikationen vermieden.

Bei der Ausbildung des Implantats hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, wenn gemäß einer Weiterbildung die — im implantierten Zustand — gefäßwandnahen Implantateile größere Stärke als die gefäßwandfernen Teile aufweisen. So können zweckmäßigerweise die gefäßwandnahen Implantateile mehrlagig ausgebildet sein, etwa in der Form, daß Flachmaterialstreifen in mehreren Lagen aufeinanderliegen, deren Flachseiten nach außen weisen, also zur Gefäßwand hin.

Die erfindungsgemäß erwünschte unterschiedliche Abbaugeschwindigkeit gefäßwandferner und gefäßwandnaher Implantateile kann aber auch, gemäß einer anderen Weiterbildung dadurch verwirklicht sein, daß die Abbaugeschwindigkeit des Materials der im implantierten Zustand gefäßwandnahen Implantateile kleiner ist als die des Materials gefäßwandferner Teile.

Eine besonders sinnvolle Ausgestaltung sieht vor, daß zur Bildung des Gefäß-Filter zumindest zwei Stränge aus biologisch abbaubarem Material in zumindest einem Punkt zusammengefaßt sind.

Gemäß einer ebenfalls vorteilhaften Ausgestaltung können die äußeren und im implantierten Zustand ge-

faßwandnahen Implantatteile mit Vorteil als lange und im wesentlichen gerade verlaufenden Berührungsstrecken ausgebildet sein, die eine sichere Platzierung und Halterung eines Cava-Filters in einem Gefäß gewährleisten.

Eine andere Weiterbildung ist durch eine als schirmartige Filterausbildung mit einer Anzahl in einem Punkt zusammengefaßter Stränge gekennzeichnet, deren von dem genannten Punkt entfernte Enden mit einem zickzackförmig unter Vorspannung zusammenfaltbaren Spreizring verbunden sind. Dieser Spreizring kann auch als metallischer Federring ausgebildet sein, der dann allerdings nach dem Abbau des Filters im Körper des Patienten verbleibt. Dies ist jedoch insofern risikolos, weil ein derartiger Federring an der Gefäßwand anliegt und dadurch in seiner Lage gehalten wird.

Ein gemäß dem vorstehenden Merkmal ausgebildeter Filter ist zum Zwecke der Implantation in einfacher Weise radial auf ein solches Maß zusammendrückbar, daß der Filter durch einen Katheter vorgeschoben werden kann, während nach der Implantation der Spreizring aufgedeutet und die von dem genannten Vereinigungspunkt der Stränge abgewandten Enden zur Anlage an eine Gefäßwand bringt.

Gemäß einer nochmaligen Weiterbildung der Erfindung, können die im implantierten Zustand gefäßwandnahen bzw. an einer Gefäßwand anliegenden Implantatteile mit Mitteln zum Verankern in einem Gefäß versehen sein. Bei diesen Verankerungsmitteln kann es sich um nach außen von den genannten Implantatteilen vorstehende Ankerstifte oder auch um kleine Haken handeln, die im implantierten Zustand in die Gefäßwand eindringen und dadurch eine formschlüssige Festlegung des Implantats sicherstellen.

Schließlich kann auch in das den Filter bildende biologisch abbaubare Material wasserlösliches Röntgen-Kontrastmittel eingemischt sein, um die Darstellung eines implantierten Filters im Röntgenbild zu verbessern.

Anhand der beigefügten Zeichnung sollen nachstehend einige Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Cava-Filters erläutert werden. In schematischen Ansichten zeigen:

Fig. 1 einen in einem nur angedeuteten Gefäß aufgenommenen Filter mit mehreren in einem Punkt vereinigten und sich von diesem in der Art der Streben eines Schirms forterstreckenden Strängen aus biologisch abbaubarem Material,

Fig. 2 eine Ansicht des Gefäß-Filters in einem der Schnittlinie II-II in Fig. 1 entsprechenden Querschnitt durch das angedeutete Gefäß,

Fig. 3 eine zu der Ausführungsform nach den Fig. 1 und 2 alternative Ausbildung eines Gefäß-Filters,

Fig. 4 in einer Ansicht wie in Fig. 1 eine Ausführungsform eines Gefäß-Filters, bei dem die den Filter bildenden Stränge beidseitig in jeweils einem Punkt miteinander verbunden sind,

Fig. 5 ebenfalls in einer Ansicht wie in Fig. 1 einen in einem nur angedeuteten Gefäß aufgenommenen Filter aus in einem Punkt miteinander vereinigten Strängen aus biologisch abbaubarem Material, deren andere Enden mit einem zickzackförmig zusammenfaltbaren Spreizring verbunden sind, und

Fig. 6 den Gefäß-Filter gemäß Fig. 5 im zusammengefalteten Zustand beim Vorschieben durch einen in ein Gefäß eingeführten Katheter.

Bei dem in den Fig. 1 und 2 veranschaulichten Gefäß-Filter 10 sind in einem Punkt 11 sechs Stränge aus biologisch abbaubarem Material gleicher Längenerstreck-

kung miteinander verbunden, die sich von dem Vereinigungspunkt divergierend forterstrecken. Diese Stränge bilden gewissermaßen die Streben 12 einer haubenförmigen Sechseckpyramide und sind an ihren von der Pyramidenspitze abgewandten Enden mit kleinen Häkchen 15 versehen, die bei der Implantation des Filters sich in der Cava-Wand 16 verhaken und dadurch den Filter lagerichtig im Gefäß 16 fixieren.

Bei dem in Fig. 3 veranschaulichten Gefäß-Filter 20 handelt es sich ebenfalls um ein Gebilde aus sechs jeweils an ihren einen Enden in einem Punkt 21 miteinander verbundenen Streben 22, die sich symmetrisch zu einer Längsachse divergierend von dem genannten Vereinigungspunkt forterstrecken. An die vom Vereinigungspunkt 21 entfernten freien Enden der Streben 22 sind jeweils parallel zueinander und in Richtung zur Spitze des Gebildes verlaufende Schenkel 24 angeformt, die auf ihren radial nach außen weisenden Seiten wiederum mit kleinen Häkchen 25 als Mittel zum Verankern in einem Gefäß ausgerüstet sind.

Anstelle des in den Fig. 1 und 3 gezeigten geradlinigen Verlaufs der Streben 12, 22 können derartige Streben auch einen vorbestimmten, konfigurierten Verlauf haben.

So sind bei dem wiederum aus sechs Strängen 32 aus biologisch abbaubarem Material gebildeten Gefäß-Filter 30 nach Fig. 4 die Stränge 32 beidseitig jeweils in einem Punkt 31, 31' fest miteinander verbunden. Fig. 4 zeigt den Filter im implantierten Zustand, in dem die Mittelteile der Streben 32 als langgestreckte Berührungsstrecken 34 an den Gefäßwänden 36 unter einer gewissen radialen Vorspannung anliegen. Die im implantierten Zustand an der Gefäßwand anliegenden bzw. die gefäßwandnahen Teile bestehen bei dieser Ausführungsform aus mehreren übereinanderliegenden Lagen 34, 34'. Diese mehrlagig ausgebildeten Führungsstrecken sind wiederum im implantierten Zustand in nicht weiter dargestellter Weise durch geeignete Verankerungsmittel fest an der Gefäßwand 36 verankert.

Angesichts der verstärkten Ausbildung der im implantierten Zustand an einer Gefäßwand anliegenden Berührungsstrecken findet der biologische Abbau eines derartigen Gefäß-Filters von innen heraus statt mit der Folge, daß zunächst die zu den Vereinigungspunkten 31, 31' hin verlaufenden Teile der Streben 32 resorbiert werden und erst danach die gefäßwandnahen Implantatteile, die gegenüber den anderen Teilen durch mehrlagige Ausbildung verstärkt sind. Ein unerwünschtes Abschwimmen der verstärkten gefäßwandnahen Implantatteile wird dadurch wirksam verhindert, daß diese bei der Implantation durch geeignete — in Fig. 4 nicht dargestellte — Verankerungsmittel an den Wandungen des Gefäßes 36 verhakt sind.

Der in Fig. 5 veranschaulichte Gefäß-Filter 40 ist in ähnlicher Weise wie die Ausbildungsform nach den Fig. 1 und 2 schirmartig ausgebildet und besteht aus einer Anzahl in einem Punkt 41 mit ihren einen Enden fest miteinander verbundenen Streben 42, deren von diesem Punkt entfernte andere Enden 43 jedoch mit einem zickzackartig ausgebildeten und unter radialer Vorspannung zusammenfaltbaren Spreizring 47 verbunden sind. Jeweils im Bereich zwischen den mit dem Spreizring verbundenen Enden zweier Schenkel erstrecken sich von dem Spreizring mit ihren Enden radial nach außen geformte Ankerstifte 45 fort, die beim Implantieren des Filters sich in der Wand eines Gefäßes 46 verhaken und dadurch eine Fixation des Filters vermitteln.

Implantiert werden derartige Filter mittels eines in  
entsprechendes Lumen aufweisenden Katheters, in dem  
der Katheter mit seiner Spitze lagerichtig in ein Gefäß  
46 eingeführt und dann das Implantat im zusammenge-  
falteten Zustand durch das Katheterlumen vorgeschoben  
wird.

Fig. 6 zeigt die Implantation des oben in Verbindung  
mit Fig. 5 veranschaulichten schirmartigen Gefäß-Fil-  
ters 40, der im zusammengefalteten Zustand in einem  
zuvor in das Gefäß 46 eingeführten Katheter 48 auf-  
genommen ist und mittels eines von der Einführseite aus  
ebenfalls in den Katheter eingeführten Schiebers 49 bis  
zur Implantationsstelle durch den Katheter vorgeschoben  
wird. Angesichts der dem Spreizring 47 des Katheters  
im zusammengefalteten Zustand eigenen Vorspannung  
entfaltet sich der Filter unmittelbar nach dem Ver-  
lassen des Katheters und federt in die in Fig. 5 ver-  
anschaulichte Implantationslage auf, in der die als Ver-  
ankerungsstifte 45 ausgebildeten Verrastungsmittel in die  
Gefäßwand eingreifen und dadurch eine lagerichtige Fixation  
des implantierten Gefäß-Filters vermitteln.

Die Implantation der in den Fig. 1 bis 4 veranschau-  
lichten Ausführungsformen erfolgt in sinngemäß gleicher  
Weise wie bei dem in Verbindung mit den Fig. 5  
und 6 oben beschriebenen Filter 40. Während bei der  
letzten genannten Ausführungsform der beim Vorschieben  
durch einen Katheter unter Vorspannung zusammenge-  
drückte Spreizring das Auffedern vermittelt, bewirken  
dies bei den anderen Ausführungsformen die Streben  
12, 22, 32, die beim Vorschieben des jeweiligen Filters  
durch einen Katheter unter radialer Vorspannung zu-  
sammengedrückt sind.

#### Patentansprüche

1. Perkutan mittels eines Katheters in ein Gefäß  
einführbarer und in diesem platzierbarer Gefäß-Fil-  
ter aus wenigstens einem unter Vorspannung radial  
zusammendrückbaren und im implantierten Zu-  
stand bis zur Anlage an der Gefäßwand auffedern-  
den Strang, insbesondere Cava-Filter, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß der Filter (10, 20, 30, 40) aus  
biologisch abbaubarem Material besteht und daß  
die gefäßwandfernen Implantatteile schneller ab-  
baubar sind als die gefäßwandnahen Implantatteile.
2. Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-  
zeichnet, daß die gefäßwandnahen Implantatteile  
größere Stärke als die gefäßwandfernen Teile auf-  
weisen.
3. Implantat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß die gefäßwandnahen Implantat-  
teile (34, 34') mehrlagig ausgebildet sind.
4. Implantat nach Anspruch 3, dadurch gekenn-  
zeichnet, daß die gefäßwandnahen Implantatteile  
als in mehreren Lagen aufeinanderliegende Flach-  
materialstreifen (34, 34') mit zur Gefäßwand hin  
weisenden Flachseiten ausgebildet sind.
5. Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
dadurch gekennzeichnet, daß die Abbaugeschwin-  
digkeit des Materials der gefäßwandnahen Implan-  
tatteile kleiner ist als die des Materials gefäßwand-  
ferner Implantatteile.
6. Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet, daß zur Bildung des Fil-  
ters (10, 20, 30, 40) zumindest zwei Stränge (12, 22,  
32, 42) aus biologisch abbaubarem Material in zu-  
mindest einem Punkt (11, 21, 31, 31', 41) zusammen-  
gefaßt sind.

7. Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
dadurch gekennzeichnet, daß die gefäßwandnahen  
Implantatteile als lange und im wesentlichen gera-  
de verlaufenden Berührungsstrecken (24, 34, 34')  
ausgebildet sind.

8. Implantat nach Anspruch 6, gekennzeichnet  
durch eine schirmartige Filterausbildung mit einer  
Anzahl in einem Punkt (41) zusammengefaßter  
Stränge (42), deren von dem genannten Punkt ent-  
fernten Enden mit einem zickzackförmig und unter  
Vorspannung zusammenfaltbaren Spreizring (47)  
verbunden sind.

9. Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
dadurch gekennzeichnet, daß die gefäßwandnahen  
bzw. an einer Gefäßwand anliegenden Implantat-  
teile mit Mitteln (15, 25, 45) zum Verankern in dem  
Gefäß versehen sind.

10. Implantat nach Anspruch 9, dadurch gekenn-  
zeichnet, daß es sich bei den Mitteln zum Veran-  
kern des Filters in dem Gefäß um von den gefäß-  
wandnahen bzw. an einer Gefäßwand anliegenden  
Implantatteilen um nach außen vorstehende Haken  
(15, 25) oder Ankerstifte (45) handelt.

11. Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
dadurch gekennzeichnet, daß in das den Filter (10,  
20, 30, 40) bildende biologisch abbaubare Material  
wasserlösliches Röntgen-Kontrastmittel einge-  
mischt ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Fig. 1


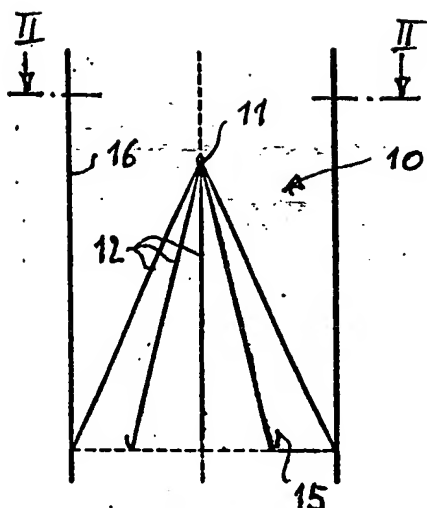


Fig. 2

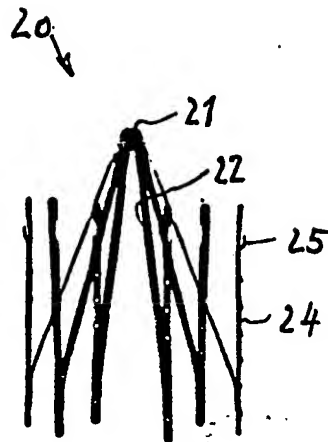


Fig. 3

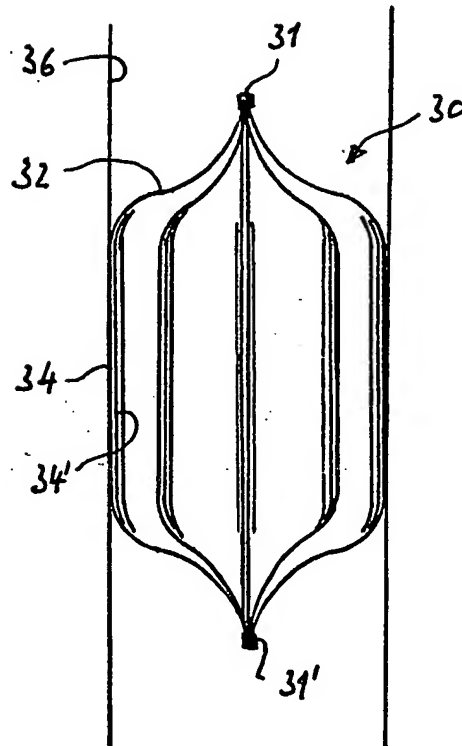


Fig. 4

Fig. 6

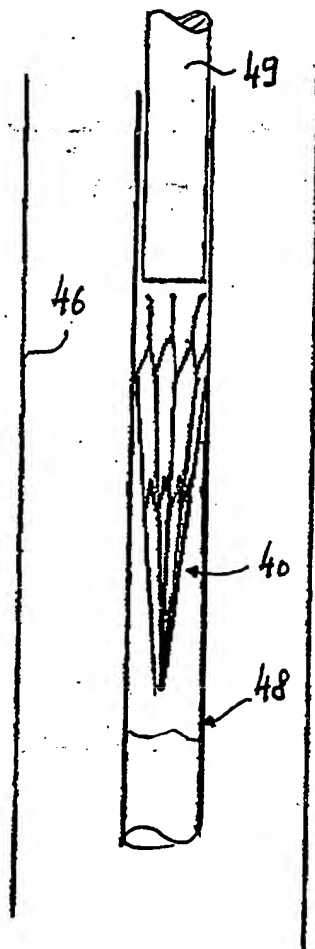


Fig. 5

